IP粉塵試験用　吸引口取付について

■適用：　IP 5X　Category1　，IP 6X　粉塵試験
筐体内空気を-2kPaで吸引します。

■試験品の
吸引箇所：　負圧の影響を最も受けやすい部分の近傍に
吸引用空圧ﾁｭｰﾌﾞを接続します。

弊社では外径6mmφの空圧ﾁｭｰﾌﾞを使用します。

■方法1：　外径6mmφ空圧ﾁｭｰﾌﾞ対応ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞを取り付ける。
"外径6mmφ　ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ"　等で検索してください。

■方法２：　外径6mmφ空圧ﾁｭｰﾌﾞを試験品の筐体内から
直接引き出す。（約300mm）
筐体穴の隙間はシール材等で適宜塞いでください。

試験品への取付は，有償にて弊社で承ります。

試験品の寸法/形状情報と併せてご相談ください。

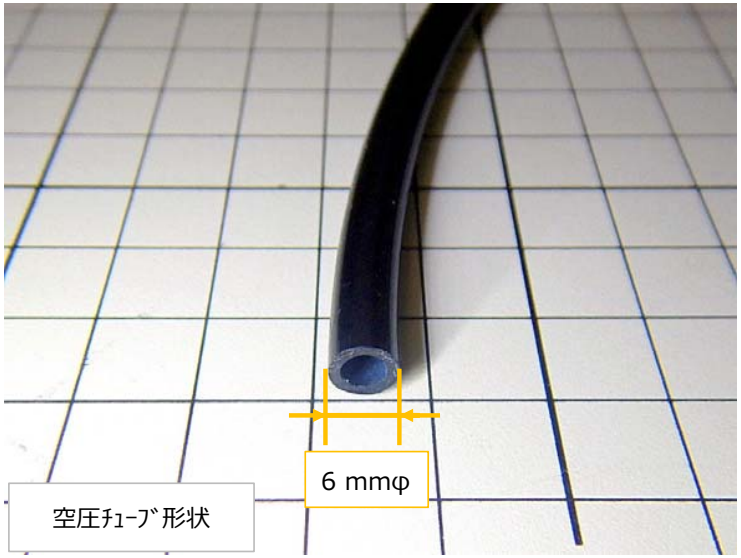

iPS CORPORATION