IP(耐水)試験治具 取付寸法図面/仕様

■適用:　IP X1, X3, X4, X5, X6　耐水性試験
■設置面　直径:　730 mm
■設置面　地上高:　205 mm
■耐荷重:　150 kg

■回転仕様:　1 回転/分

時計方向連続回転
または
1回転毎　時計方向/半時計方向に反転

■試験品固定ねじ間隔:　70 mm ＊ 70 mm

■試験品固定ねじ仕様:　M 8 ＊ 4 個
治具貫通厚みに加え,
深さ10mm～20mmを加算した
固定ねじが必要です。

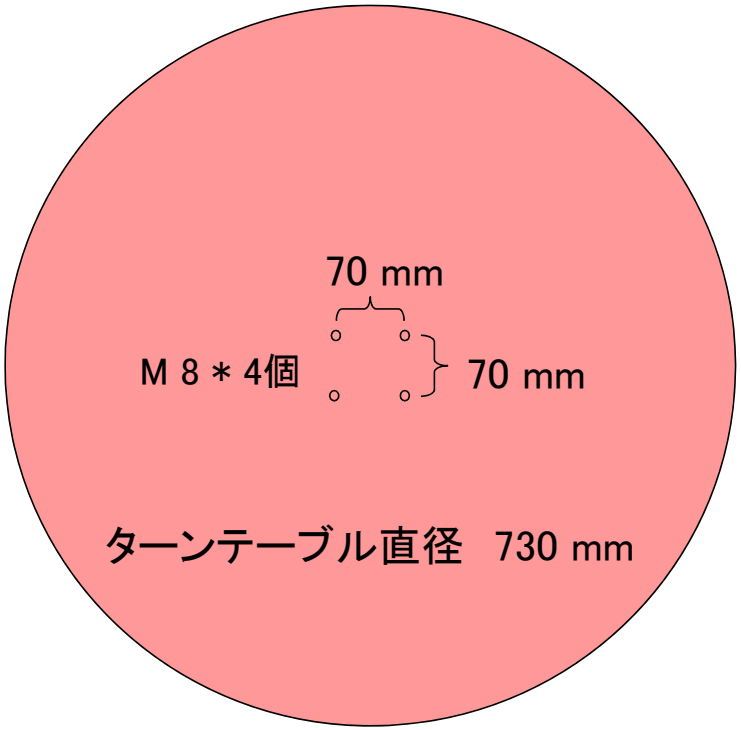

試験品の搭載可否は, 試験品の寸法/形状情報と併せてご相談ください。

IPS CORPORATION